

SATURAZIONE OSSIGENO
AUTO SHUT-OFF

FREQUENZA DEL POLSO
AUTO SHUT-OFF

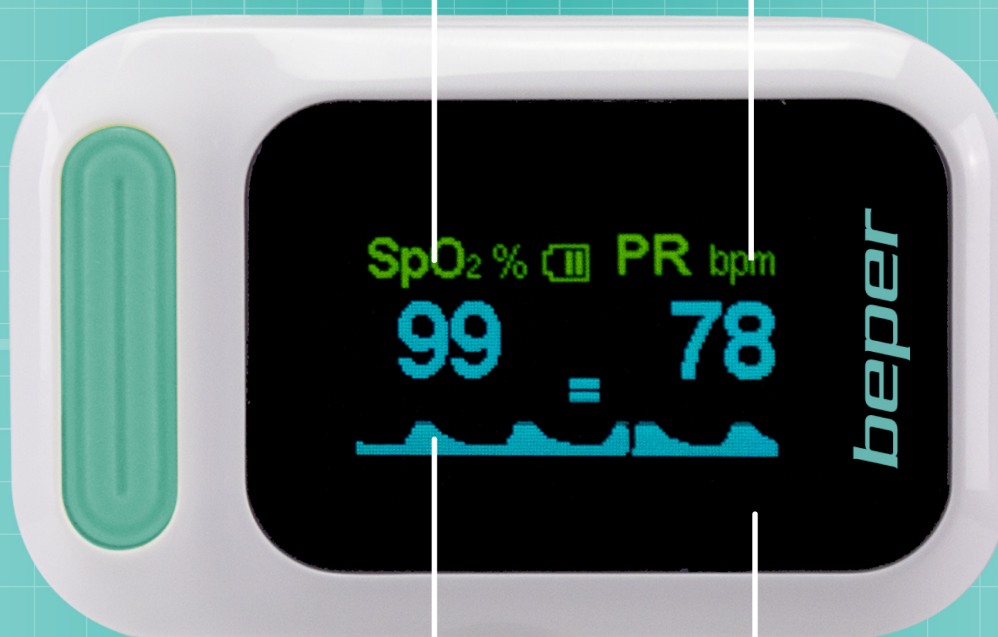


GRAFICO CURVA IMPULSO
PULSE CURVE GRAPH

DISPLAY LED
LED DISPLAY

FINGER- SAUERSTOFFSÄTTIGUNGSMESSGERÄT

P303MED050

Einfach zu bedienendes Finger-Pulsoximeter, das dank der Ein- und Ausschaltautomatik in der Lage ist, den Blutsättigungsindex (SpO2) und die Herzfrequenz genau zu ermitteln. Ausgestattet mit einer großen LED-Anzeige, Alarm bei Sättigungsgrad unter 90 und Batteriestatusanzeige. Batteriebetrieb (2xAAA nicht enthalten).

beper



FINGER- SAUERSTOFFSÄTTIGUNGSMESSGERÄT

P303MED050

PRODUKTABMESSUNGEN: 3,6X3X5,5 CM

MATERIAL: ABS

BATTERIE: 2XAAA NICHT ENTHALTEN

NETTOGEWICHT: 1.1 KG

VERPACKUNGMAß: 19X12X6,5 CM


VERPACKUNGSEINHEIT: LITHOGRAPHIERTE
SCHACHTEL

STÜCKE PRO PAKET: 6

STÜCKE PRO PALLET: 42



Video

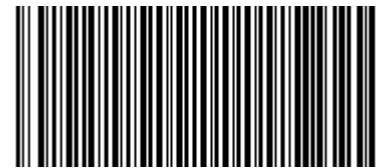

8056420222647

Beper S.r.l.

Via Antonio Salieri, 30 37050 Vallese di Oppeano (VR)

www.beper.com